

# HIKARI®

## DECIBELÍMETRO DIGITAL

## HDB-911



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

## ÍNDICE

VISÃO GERAL.....	02
ITENS INCLUSOS E OPCIONAIS .....	02
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA .....	03
SÍMBOLOS INTERNACIONAIS .....	03
ESTRUTURA DO INSTRUMENTO .....	04
DISPLAY DO INSTRUMENTO .....	04
ESPECIFICAÇÕES GERAIS .....	05
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO .....	05
ESPECIFICAÇÕES DE PRECISÃO .....	07
MANUTENÇÃO .....	08
A. Serviço Geral.....	08
B. Troca de Bateria.....	08
GARANTIA DO PRODUTO.....	09

## VISÃO GERAL

Este manual de instruções cobre informações de segurança e cautelas. Por favor, leia as informações relevantes cuidadosamente e observe todas as **Advertências** e **Notas** rigorosamente.

### Advertência

**Para evitar choques elétricos e ferimentos pessoais, leia as Informações de Segurança cuidadosamente.**

O Decibelímetro Digital Hikari **Modelo HDB-911** (daqui em diante referido apenas como instrumento) se destaca por medir nível sonoro de 35dB a 130dB em uma faixa de medida e temperatura ambiente de -20°C a 70°C (-4°F a 158°F). O projeto da estrutura adota um design anatômico, diferente dos padrões convencionais. Como característica adicional apresenta as funções Hold, Máximo, Mínimo, Fast e Slow.

## ITENS INCLUSOS E OPCIONAIS

Observe abaixo os itens inclusos e opcionais (não inclusos):

Item	Descrição	Qtd
1	Instrumento	1 peça
2	Manual de Instruções	1 peça
3	Espuma Protetora contra Vento	1 peça
4	Pilha AAA 1,5V (opcional)	3 peças

No caso da falta de algum componente ou que esteja danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as informações contidas neste Manual de Instruções para a sua familiarização com o instrumento, antes de utilizá-lo.

Ao efetuar reparos no instrumento, utilize somente as peças de reposição especificadas.

Nunca efetue medidas com o instrumento nos seguintes casos:

- Após armazenamento ou acondicionamento do instrumento em condições anormais (atmosfera explosivas, gases inflamáveis, fumaça, vapor ou poeira);
- Com o instrumento aberto. Este instrumento foi projetado levando-se em consideração os aspectos de sua segurança. Entretanto, nenhum projeto pode estar completamente protegido contra uso incorreto.

## SÍMBOLOS INTERNACIONAIS



Conformidade com as Normas da União Europeia


## INTRODUÇÃO

Este instrumento está em conformidade com a Norma IEC-61672 Classe II para Medidores de Nível Sonoro.

Este Decibelímetro foi projetado para atender as exigências de precisão em medidas para engenheiros de segurança, especialistas nas áreas de saúde, segurança industrial, controle de qualidade e vários outros ambientes. Observe suas características:

- Faixa de Medição: 35dB ~ 130dB em frequência entre 31.5Hz e 8kHz.
- Display com resolução de 0.1dB em um visor LCD de 4 dígitos.
- Nível de Ponderação A.
- Faixa de Medida: Baixa 35dB ~ 100dB; Alta 100dB ~ 130dB.
- Tempo de Resposta: Rápida (125ms) e Lenta (1s).


## ESTRUTURA DO INSTRUMENTO

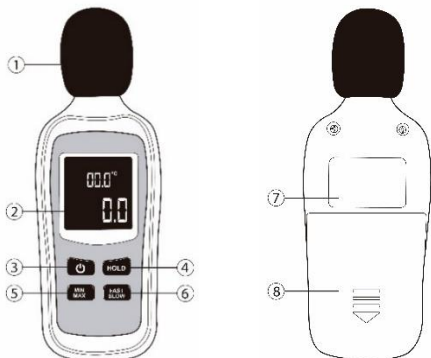


1. Espuma de proteção do microfone;
2. Display LCD;
3. Tecla Liga/Desliga;
4. Tecla Hold;
5. Tecla Max/Min;
6. Tecla Fast/Slow;
7. Etiqueta de identificação (parte traseira);
8. Compartimento de bateria (parte traseira).

## DISPLAY DO INSTRUMENTO

1. Indicação Data Hold;
2. Indicação Auto Desligamento;
3. Indicação Max/Min;
4. Indicação de Bateria;
5. Display Auxiliar (Leitura de Temperatura);
6. Unidade de Temperatura;
7. Display Principal (Leitura de Nível Sonoro);
8. Indicação Fast/Slow;
9. Indicação Hi/Lo;
10. Unidade de Nível Sonoro.

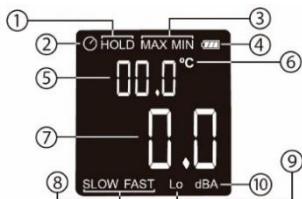

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Indicação de Sobrefaixa: “OL” é mostrado no display principal.
- Auto Power Off: Aprox. 15 minutos.
- Indicação de bateria fraca:  é mostrado no display.
- Ambiente de Operação: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F), RH<90%.
- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F), RH<75%.
- Tipo de Bateria: 3 x Pilha AAA 1,5V.
- Microfone: Eletreto condensador de 1/2 polegada.
- Segurança / Conformidade: IEC 61672-1 CLASSE II
- Dimensões: 144(A) x 56(L) x 30,5(P)mm.
- Peso: Aproximadamente 103g (incluindo pilhas).
- Duração da bateria: Aproximadamente 60 horas.



## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

### Operação






### Advertência

**Correntes de vento através do microfone causarão ruídos estranhos adicionais. Ao utilizar o instrumento na presença de vento, é necessário utilizar a espuma de proteção contra o vento, que impede a captação de ruídos indesejáveis.**



1. Abra o compartimento da bateria e insira 3 pilhas AAA 1,5V.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga  para ligar o instrumento.
3. Direcione o microfone à fonte do ruído a ser medido.
4. O display irá mostrar automaticamente as medidas de nível sonoro e temperatura.
5. Pressione a tecla Liga/Desliga  para desligar o instrumento.




### Modo Hold

A tecla “HOLD”  congela a medida no display enquanto estiver ativa, impossibilitando a alteração do valor no display.



1. Pressione a tecla “HOLD”  para ativar a função e congelar o display. Enquanto a função estiver ativa a indicação “HOLD” será mostrada no display.
2. Pressione a tecla “HOLD”  novamente para desativar a função.



## Modo Max/Min

A tecla “Max/Min”  mostra os valores máximo e mínimo medidos após a ativação da função. Utilizando a tecla “Max/Min” , é possível alternar entre os valores máximo e mínimo livremente.

1. Pressione a tecla “Max/Min”  para ativar a função “Máximo” e mostrar o valor máximo no display. Enquanto a função estiver ativa a indicação “MAX” será mostrada no display.
2. Pressione a tecla “Max/Min”  novamente para ativar a função “Mínimo” e mostrar o valor mínimo no display. Enquanto a função estiver ativa a indicação “MIN” será mostrada no display.
3. Pressione e segure a tecla “Max/Min”  por aproximadamente 3 segundos para desativar a função e retornar ao modo convencional de medida.

## Seleção de medida Fast/Slow

A tecla “Fast/Slow”  seleciona a velocidade de resposta do instrumento. Por padrão, sempre que o instrumento for ligado a velocidade de resposta selecionada será “Fast”. Utilizando a tecla “Fast/Slow” , é possível alternar entre as velocidades de resposta livremente.



1. Pressione a tecla “Fast/Slow”  para mudar a velocidade de resposta para “Slow”. Quando a função estiver ativa a indicação “SLOW” será mostrada no display e a velocidade de resposta será de 1 segundo.
2. Pressione a tecla “Fast/Slow”  para retornar a velocidade de resposta para “Fast”. Quando a função estiver ativa a indicação “FAST” será mostrada no display e a velocidade de resposta será de 125 milissegundos.

## Medida de temperatura

O instrumento possui um display auxiliar que mostra medidas de temperatura de ambiente, esse display está sempre ativo e faz medidas em graus Celsius e Fahrenheit.

## Unidade de medida de temperatura





É possível alternar entre as medidas de Celsius e Fahrenheit.

1. Com o instrumento desligado, pressione e segure a tecla "HOLD",  e então ligue o produto pressionando a tecla Liga/Desliga  e segurando ambas as teclas por aproximadamente dois segundos para alterar a unidade de medida de temperatura.

## Auto desligamento

O instrumento possui a função de auto desligamento. Após aproximadamente 15 minutos sem ser pressionada nenhuma tecla, o instrumento se desligará automaticamente.

É possível ativar ou desativar essa função:

1. Com o instrumento desligado, pressione e segure a tecla "Max/Min"  e ligue o produto pressionando a tecla Liga/Desliga , mantenha apenas a tecla "Max/Min"  pressionada por aproximadamente dois segundos, o símbolo  desaparecerá do canto superior esquerdo do display, desativando a função de auto desligamento.
2. A função de auto desligamento será ativada sempre que o produto for desligado.

## ESPECIFICAÇÕES DE PRECISÃO

### A. Nível Sonoro

Faixa	Resolução	Precisão
35dB ~ 130dB	0,1dB	±2,0dB

- Observações**
- Faixa dinâmica: 50dB
  - Leitura "Hi": >100dB
  - Leitura "Lo": <100dB
  - Frequência: 31,5Hz ~ 8kHz

### B. Temperatura

Faixa	Resolução	Precisão
-20°C ~ 70°C (-4°F~158°F)	0,1°C/°F	±1,5 C (2,7°F)

- Observações**
- Taxa de amostragem: Aproximadamente 3 medidas por segundo.



## MANUTENÇÃO

Esta seção fornece informações de manutenção básicas do instrumento incluindo instruções de troca de bateria e fusível.

### **Advertência**

**Não tente reparar ou efetuar qualquer serviço em seu instrumento, a menos que esteja qualificado para tal tarefa e tenha em mente informações sobre calibração, testes de desempenho e manutenção.**

**Para evitar choque elétrico ou danos ao instrumento, não deixe entrar água dentro do instrumento.**

### **A. Serviço Geral**

- Periodicamente limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos ou solventes.
- Desligue o instrumento quando este não estiver em uso.
- Retire a bateria quando não for utilizar o instrumento por muito tempo.
- Não utilize ou armazene o instrumento em locais úmidos, com alta temperatura, explosivos, inflamáveis e fortes campos magnéticos.

### **B. Troca de Bateria**

#### **Advertência**

**Para evitar falsas leituras, troque a bateria assim que o indicador de bateria fraca aparecer.**

Para trocar a bateria:

1. Separe a tampa do compartimento das pilhas do gabinete.
2. Remova as pilhas do compartimento.
3. Recoloque três pilhas AAA 1,5V novas.
4. Encaixe a tampa do compartimento.

## **GARANTIA DO PRODUTO**

1. O prazo de garantia deste produto é de 12 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Unicoba ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Unicoba para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Hikari pelo telefone (11) 5070-1717 ou via e-mail através do [suporte@unicoba.net](mailto:suporte@unicoba.net).
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Unicoba ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e número de série.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
  - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
  - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
  - c) Mau uso, esforços indevidos ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
  - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
  - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
  - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
  - g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.



# **HIKARI®**

Importado por:  
Unicoba Importação e Exportação Ltda.  
CNPJ 43.823.525/0002-10  
Tel (11) 5070-1700 Fax (11) 5070-1724  
suporte@unicoba.net  
www.hikariferramentas.com.br

Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.